

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.662.002 BL

Volumetric flasks A

Messkolben A




Batch No. 16-15

Code: 81606

Testvolumen 20.0000 ml Variationskoeffizient 0.0343 %
 Test volume: 20.0000 ml Coefficient of variation: 0.0343 %

Toleranz 0.0400 ml Richtigkeit 0.0467 %
 Tolerance: 0.0400 ml Accuracy: 0.0467 %

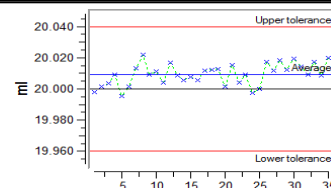

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 29.04.2015



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**